




# Procesamiento del Instrumental de Cirugía Oftalmológica de Urgencia

Jornada de esterilización  
Mar del plata 2017

# Cirugía Oftalmológica de Urgencia

- Anestesia general.
- Traumáticas.
- Reparadoras.

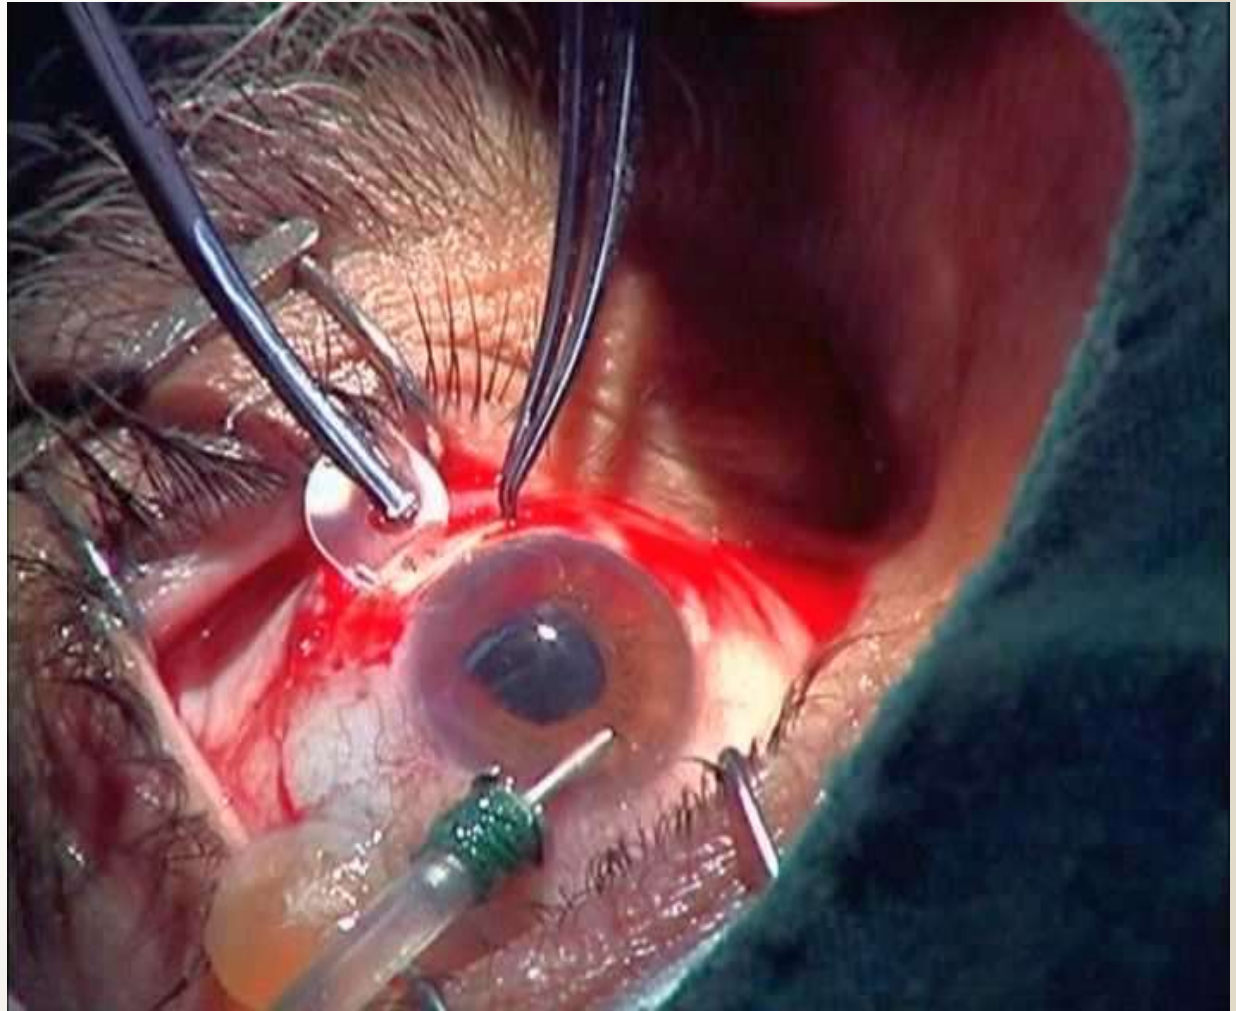

# Caja de Instrumental



## ► Instrumental delicado:


- Pinzas.
- Porta agujas.
- Bléfaros.
- Tijeras.
- Manipuladores.
- Ganchos.

# Pinzas

- Sujetar Iris, Córnea, etc.
- Suturar.
- Manejo de membranas.



**UTRATA**



**BARRAQUER**



**COLIBRI**




**PINZA PARA CONJUNTIVA**

# Porta Agujas

- Sustener la aguja durante la sutura



**BARRAQUER**




**CASTRO VIEJO**




# Bléfaros




**Ajustable: para adultos**




**No ajustable: pediátrico**



# Tijeras



**Tijera de Iris**



**Castro Viejo**




**Vannas**

# Manipulador y Gancho






# Cánulas



**Reutilizable**



**Descartable**

# Procesamiento del Instrumental

## Lavado y Secado

- Lavado manual.
- Cepillado manual, delicado.
- Doble enjuague.
- Secado minucioso.



# Procesamiento del Instrumental



## Acondicionado

- Caja con base de silicona.
- Envoltorio de doble polipropileno.



# Esterilización

- ➔ Esterilización por Vapor de Agua.



# Esterilización


- Esterilización por Plasma de Peróxido (Sterrad 100S).



# Resumiendo:

- Material delicado.
- Lavado manual.
- Secado exhaustivo.
- Esterilización: vapor, plasma.



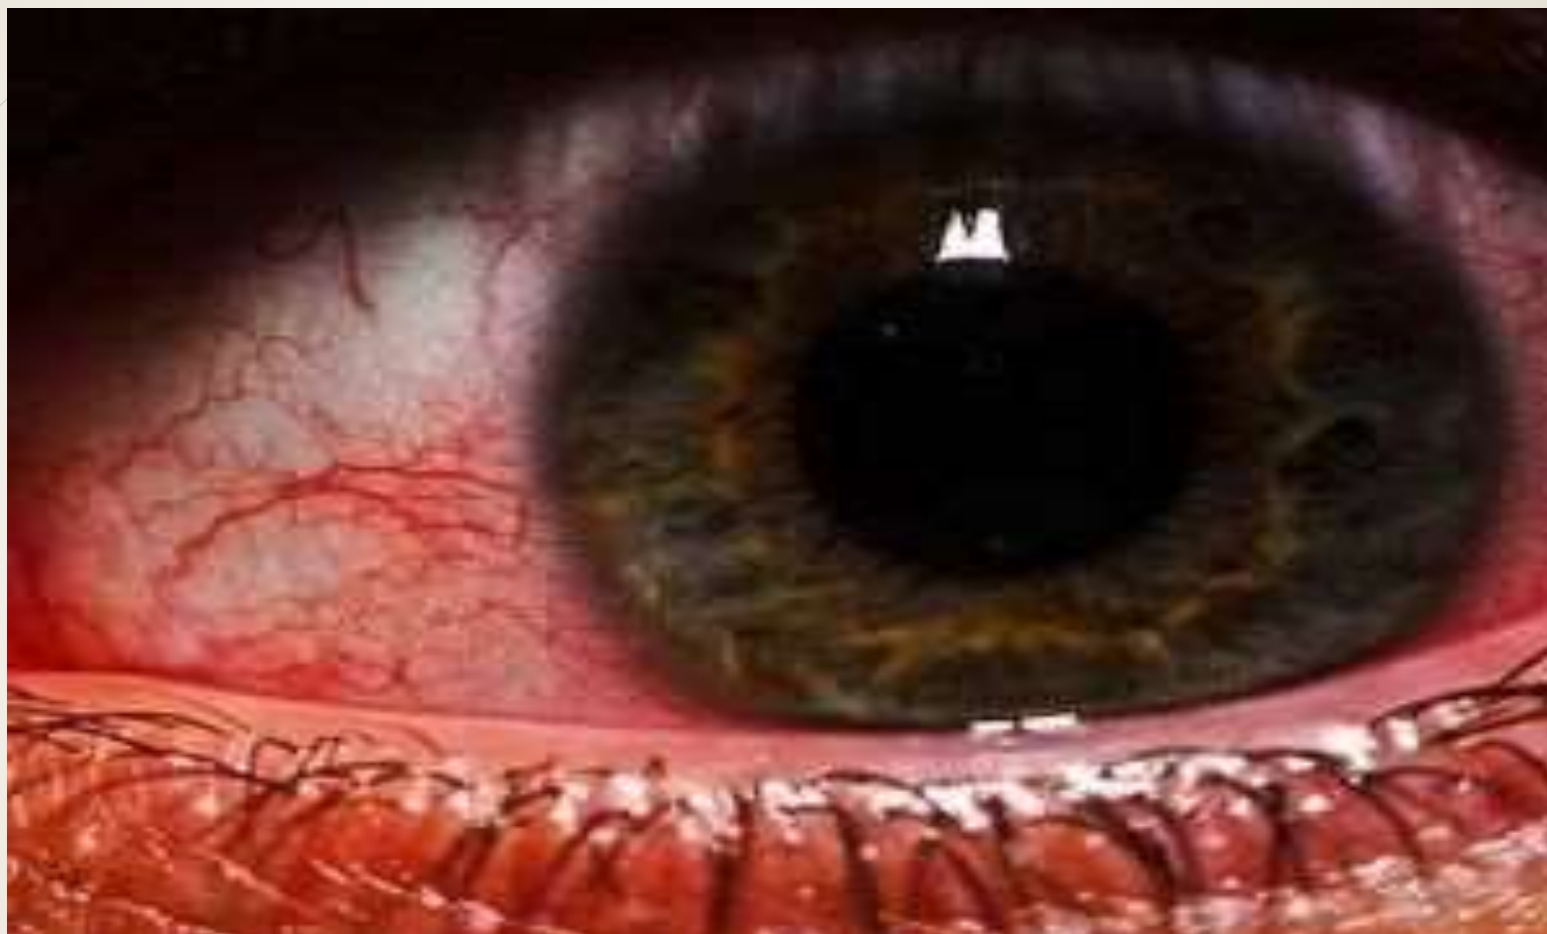

Muchas gracias!!!